




Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 20 µl, transparente, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
unidades/StackPack

Página 1

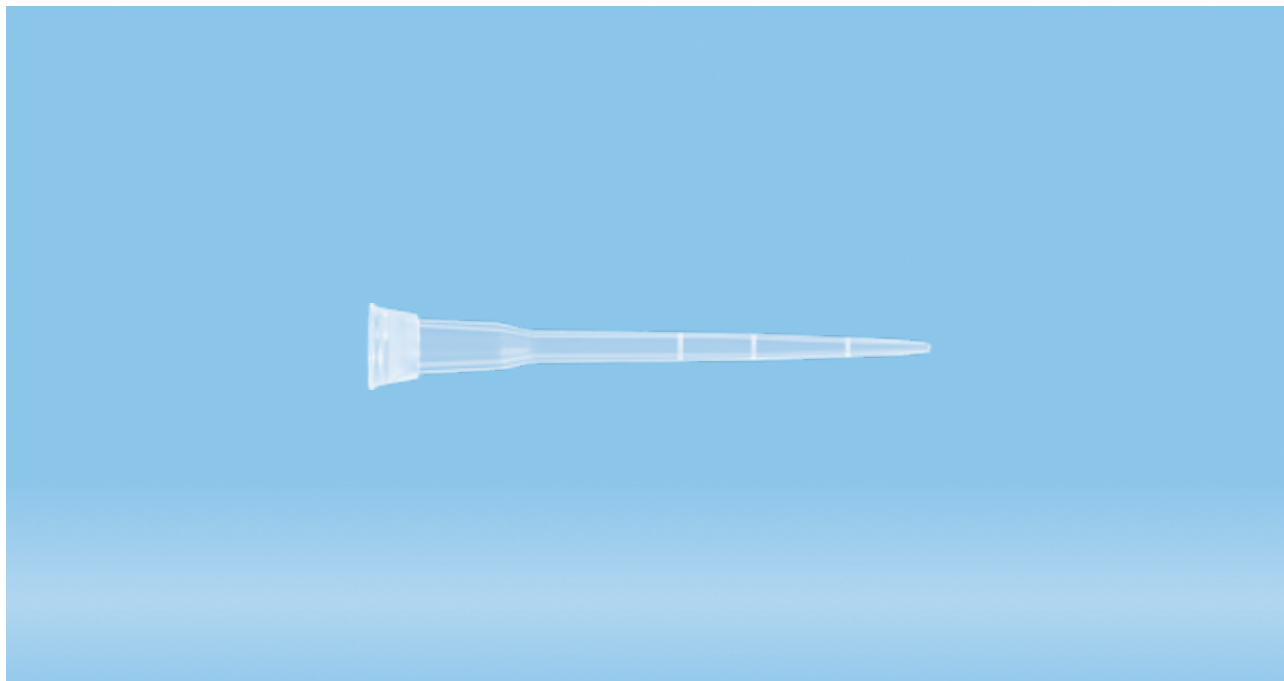

Descripción del artículo

Número de pedido	70.3020.110
Descripción del artículo	Punta de pipeta, volumen de trabajo: 20 µl, transparente, anillos de nivel de llenado, PCR Performance Tested, Low Retention, adecuada para SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características, 480 unidades/StackPack

Características del producto

Graduación	sí
Indicado para	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette y Brand y modelos de similares características
Volumen de trabajo	20 µl
Filtro	no
Codificar color	gris

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-26

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Punta de pipeta, 20 µl, transparente, PCR
Performance Tested, Low Retention, 480
unidades/StackPack

Página 2

Dimensiones

Volumen máx.	20 µl
Longitud del producto	46 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	PCR Performance Tested
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1920
Tipo de embalaje	StackPack
unidades / caja interna	1920
unidades / caja	1920
unidades / pallet	215040
Profundidad de la caja	290 mm
Ancho de la caja	216 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0141 cbm
Peso del producto	0.0005 kg
Peso de la caja	1.69 kg
EAN de la caja interna	4038917894029
EAN de la caja	4038917894036

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-26

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT