

分子生物学とPCR製品

qPCR用推奨製品



Life Science



SARSTEDTは1961年より、医学・化学のアプリケーション向けに高品質製品を開発・製造してきました。

以下のページでご紹介する当社の幅広い製品シリーズから、PCR反応プロセスをさらに最適化するための貴重なヒントをご覧いただけます。

当社製品の一貫した高品質を保証するため、当社は以下の基準を設定しています。

- よく考えられた製品と、均一の壁厚を実現する金型設計
- 高品質原材料の使用（医療グレード素材など）
- クリーンルーム条件下での自動生産
- 入念な品質管理（100%の気密性テストなど）
- ISO 13485認定の品質管理システム
- 高度なトレーニングを積んだ従業員

一丸となって当社の優れた製品品質「Made in Germany」を実現しています。

標準の製品シリーズに加え、特定の生体分子に対するLow Binding（低吸着）特性を実現したり、最高の清浄度を備えるなど、最先端技術を駆使した高性能製品も提供しています。特別なご要望に応じてカスタマイズした製品の生産も承ります。ご興味のある方は当社までお気軽にお問い合わせください。

SARSTEDTチーム一同

コンテンツ

清浄度最高レベルの製品で今すぐスタート！	4
PCRで使用するプラスチック品質の重要性 - 先進的な製造基準により、すべての (q) PCRアプリケーションで信頼できるパフォーマンスを実現	4
高感度分析のための最大清浄度と信頼性	5
PCR Performance Tested	5
Biosphere® plus - さらなる安全性を	5
感度の最適化と再現性の向上	6
DNA & Protein Low Binding - サンプル回収率を最大限に	7
SARSTEDTのMultiply® PCRプレート – 最大限の信頼性	8
スカート付PCRプレート – 最大効率とばらつきの削減	9
Protein Low Binding PCRプレート スカート付	10
ハーフスカート付PCRプレート – High Profile	12
ハーフスカート付PCRプレート – Low Profile	14
PCRプレート (スカートなし) – High Profile	16
PCRプレート (スカートなし) – Low Profile	18
384 ウエルPCRプレート	20
Multiply® PCRプレート – 互換表	22
PCRチェーンキップ	24
シーリングテープ/ホイル	26
実用的なプリセット式 – ポリカーボネート製フレーム付き2コンポーネントPCRプレートの代替品	28
PCR8連チューブ (キップ別)	30
個別キップ一体型PCRチェーン	33
キップ付シングルPCRチューブ	35
インテリジェントなラック&ピペットシステム	36
SARSTEDTラックシステム – フレキシブルな保管/ピッティングステーション	37
正常なPCR反応を実現するためのヒント/ガイドライン	38

清浄度最高レベルの製品で今すぐスタート！

クリーンルーム、保護服着用の研修を受けたスタッフ、自動化されたプロセスでの製造はSARSTEDT品質認証の前提条件です。

私たちは第三者機関による入念な品質管理を定期的に行っているため、ユーザーが使用前に追加でチェックする必要の無い、信頼のおける消耗品を提供しています。

現在でも一部では消耗品のオートクレーブ処理が一般的に行われています。滅菌製品とDNAフリー製品を混同している人は少なくありません。しかし、滅菌処理ではDNA、RNase、Pyrogenといった余計な生体分子は除去できません。でもさらに深刻なのは、オートクレーブ処理によって製品の汚染を引き起こす恐れがあることです。またラボで発生した

廃棄物をオートクレーブし、その中から綺麗な製品だけを取り出して再利用するというのは、長い目で見ると良いことはありません。オートクレーブ装置内には以前処理した製品に付着していたプラスミドやRNaseが残留しており、新たに処理する際に簡単にコンタミしてしまいます。

この余分な、またリスクの高い作業を省くため、今すぐ SARSTEDTが認定する高清浄度製品の導入をご検討ください。

PCRで使用するプラスチック品質の重要性 - 先進的な製造基準により、すべての (q) PCRアプリケーションで信頼できるパフォーマンスを実現

PCR関連製品の製造時、弊社はプラスチック製の消耗品に影響を与える重要なパラメータに気を付けています。それは精密な形状の設計と構成から始まります。というのも精密な金型のみが非常に均一なプラスチック製品を生産でき、そのウェルの均一性によってデータのばらつきを最小限に抑えることができるためです。これらの製品は超高レベルのクリーンエリアの中で、自動プロセスにより製造されます。ごく微量の化学物質でもPCR増幅を阻害する可能性があるため、入念な洗浄プロセスを実行します。当社の生産プロセスは、成形から最終梱包に至るまで、層流によって保護された複合システムを用い、管理条件の下、高度に自動化されて実行されます。

SARSTEDT製品の製造には、多様な国際ガイドラインおよび規格（主にいわゆる医療グレード）に準拠した最高の純度と品質の厳選された原材料のみを使用しています。当社では、当社の最大品質の哲学を支持するサプライヤーのみを採用しています。もちろんビスフェノールや殺生物剤などの添加物

も一切使用していません。どの素材も各用途に応じて慎重に選び、製品を最大限に活用できるよう特別に認定されています。

当社の生産基準はウェル一つ一つの気密性のテストや製品形状の確認など、効率的な品質管理で締めくくられます。特に常に均一の壁厚を生成する品質の一貫性により、いつでも正確かつ再現可能なPCR結果を保証します。

高感度分析のための最大清浄度と信頼性

PCR Performance Tested



当社の品質認証「PCR Performance Tested」は、核酸分析用に特別に開発されました。すべての「PCR Performance Tested」認証品は第三者の認証機関より、ヒト・細菌のDNA、DNase、RNase、PCR阻害物質が含まれていないことを証明されています。消耗材の製造で使用する添加剤はPCR阻害に影響を与える可能性があるため、PCR阻害剤に対する追加の検査が重要となります。

また貴重なサンプルに簡単に入り込む恐れのある様々な物質も、PCR反応の強力な阻害剤として作用します。よく知られた例としてヘモグロビンやエタノールがあり、これらはよく核酸の単離などに使用されます。しかしながらPCR阻害剤の多くはまだ知られていません。例えば喀痰サンプルにはPCR阻害作用がよく見られますが、この原因となる構成要素はまだ特定されていません。PCR阻害剤はとりわけ阻害作用が異なる標的遺伝子に様々に作用する場合に深刻となります（例えばハウスキーピング遺伝子の増幅が並行して分析された目的の遺伝子の増幅よりも多かれ少なかれ影響を受ける場合）。従ってPCR阻害物質フリーであることが証明された製品のみを使用するのがベストです。

RNAの取り扱いでは、偏在するRNaseは常に課題となります。関連性のあるDNaseとは対照的に、RNaseの多くは活性化にMg²⁺などの補因子を必要としません。またRNaseは非常に安定しており、熱が加わると元の構造に勝手に戻る特性があります。

当社は「PCR Performance Tested」製品の以下の制限値の遵守を保証します。

Humane DNA	< 0,5 pg / µl
Bacterial DNA	< 0,02 pg / µl
DNase	< 1 x 10 ⁻⁵ U / µl
RNase	< 1 x 10 ⁻⁹ Kunitz units / µl
PCR inhibitors	< 0.5サイクル C _t 値シフト

Biosphere® plus – さらなる安全性を



ますます多くの用途において、DNAやその他の生体分子の絶対的な不在が求められるようになってきています。そのためBiosphere® plus認証製品には、さらに検証済みの汚染除去プロセスが適用されています。エチレンオキシド(EtO)

を用いた処理により、存在しうるあらゆるDNAやその他の生体分子が破壊され、製品を滅菌します。さらにPyrogenやATP（発行ベースアッセイ）が存在しないことを証明するテストにより、Biosphere® plus認証が完成します。

ごくわずかな汚染も確実に排除するため、当社はBiosphere® plus認証製品は以下の基準を満たしていることを保証します。

Humane DNA	< 5,0 fg / µl
Bacterial DNA	< 0,2 fg / µl
ISO 11135に準拠した滅菌検証	
ATP	< 1 x 10 ⁻¹² mmol / µl
Pyrogens/endotoxins	< 0,002 EU / ml
DNase	< 5 x 10 ⁻⁷ U / µl
RNase	< 5 x 10 ⁻¹¹ Kunitz units / µl
PCR inhibitors	< 0.5サイクル C _t 値シフト

感度の最適化と再現性の向上

リアルタイムPCR (qPCR) などの蛍光ベースのアプリケーションは、特に少量を用いる場合、白色PCRチューブの非常に優れた反射特性を利用します。さらに不透明の着色により壁を通して蛍光が失われることではなく、最適化された白色染料の反射によって、検出器に到達する蛍光量は、透明な製品を使用した場合よりも一定になります。これは実験を繰り返すとき、またはduplicatesやtriplicatesの場合、分散を少なくできることを意味しています。

更に白色PCRチューブの蛍光レベルが高く、使用されるフルオロフォアの背景効果が均一であるため、バックグラウンド蛍光も向上します。隣接ウェルからの分散蛍光の検知や、最悪の場合にはそれに伴った偽陽性の検出も、白色で着色することによって防止することができます。

ただ、白色PCRチューブ最大のメリットは、透明な材料に比べて感度が大幅に改善されていることです。図1は、測定された蛍光強度が、同量のテンプレートと酵素量において、透明のチューブよりも白色チューブの方が著しく高くなっていることを示しています。さらに C_t 値は 24.87 ± 0.08 （透明）から 23.40 ± 0.07 （白）に減少しており、白色チューブの1,000テンプレートの分子検知がより早く行われることを示しています。これは特にごく少量の出発物質しか利用できない場合さらにもう一つの大きなメリットとなります。

その結果、透明から白色のPCRチューブに切り替える際、実験量を減らしてコスト削減することも可能です。こうすることで使用する試薬（酵素、プローブ、プライマーなど）の量を大幅に削減し、それによって試薬の費用を抑えることができます。

白色CRチューブを使用することには、大きなメリットがあります。従って、ウェルの側面または下からの目視検査ができるというだけで、結果を妥協しないでください。

白色ウェルと透明ウェルの蛍光レベルの比較

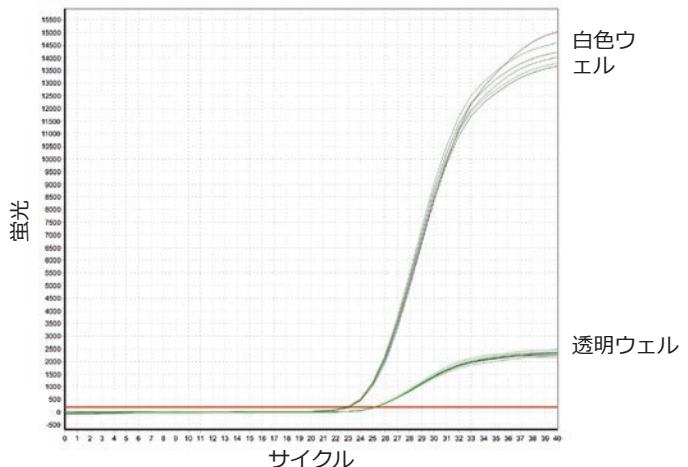


図1: 72.985.002 (透明) と 72.985.092 (白色) のチューブを透過性の高いキャップ 65.989.002 でフタをした場合の比較。EmGFP プラスミドの 100 bp フラグメント (テンプレート量 1000 分子) を、Eppendorf realplex 4S Thermocycler (n=8) を使用して容量 20 μ l で増幅。

DNA & Protein Low Binding - サンプル回収率を最大限に

微量サンプルによる分析がトレンドとなり、サンプルと容器の相互作用を最小限に抑えることが重要になってきています。またPCRチューブが他の用途でも使用される場面が増え、多くの場合で高いサンプル回収率が求められます。特に（低濃度）核酸サンプルの調整や保管、また希釈系列の調整において、すべての生体分子をキャビティから回収できるようになることは非常に重要です。

タンパク質やペプチドのマススペクトル分析で、通常のガラスバイアルや通常のPP容器を用いた場合、タンパク質やペプチドをロスすることはよく知られています。Protein Low Binding製品の使用により、はるかに多くのタンパク質またはペプチドを回収し、その後の分析に回すことができます。またProtein Low Bindingチューブの内壁との相互作用により、酵素の変性を低減させるため、酵素が使用される場合その活性も維持されます。タンパク質濃度が一定の値を下回った場合、従来のチューブを用いたタンパク質分析の信頼性はかなり下がります。また、免疫沈降、タンパク質の精製または分離、さらにタンパク質、ペプチドあるいは抗体サンプルの保管においても、Protein Low Binding製品を使用することで最大限の信頼性がもたらされます。

Protein Low Binding -タンパク質損失の比較表示：

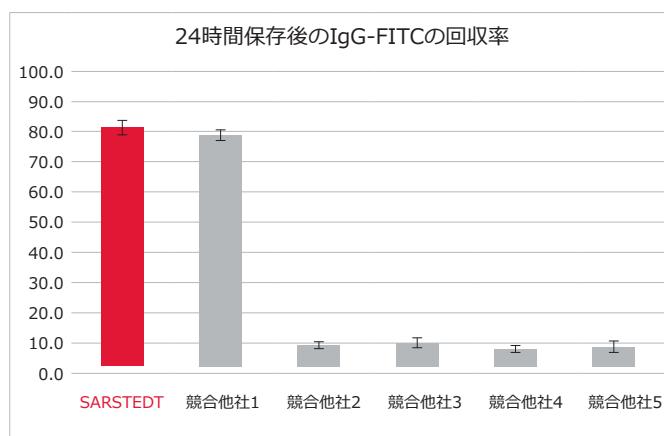


図2: IgG-FITC共役溶液 (PBS中1.0 µg/ml ; Sigma Aldrich、商品番号F9636) をそれぞれ8 x 125 µl. SARSTEDTならびに競合5社のProtein Low Binding製品に24時間保存した。培養後、それぞれ100 µlを、あらかじめ2時間以上1x Roti-Block (Carl Roth、商品番号A151.4) でブロックした黒色ELISAプレート (SARSTEDT、商品番号82.1581.220) に移し、プレートリーダーInfinite 200 pro(Tecan)で測定、テストは3日間連続で行った。SARSTEDT Protein Low Binding製品での保存は、テストしたほとんどの競合製品とは対照的に、目立った損失は見られなかった。ただし競合他社製品で同様の高い回収率を示したのもただ1社あった。

核酸またはペプチド／タンパク質に対する当社製品の低吸着特性は、特殊な原材料を使用し、特別な物理的処理を施していることから生じています。この特別な特性を実現するにあたり、当然ながらシリコンやそれに類した素材でのコーティングは使用していません。

DNA Low BindingおよびProtein Low Binding特性を備えた最先端の製品を提供しています。

DNA Low Binding -DNA損失の比較表示：

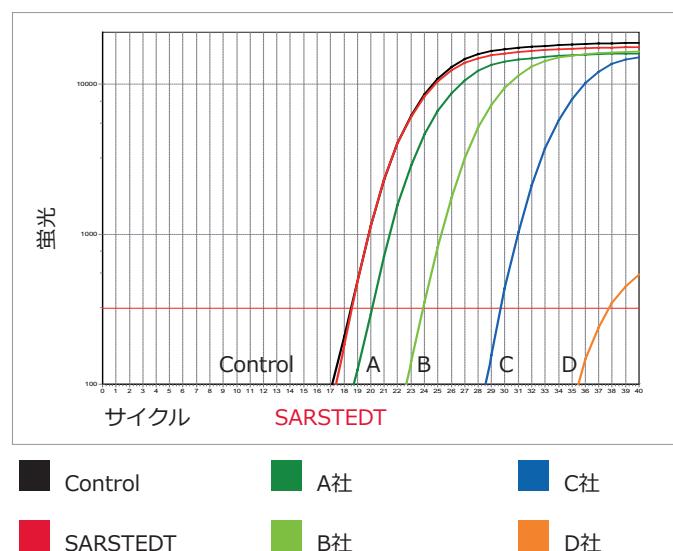


図3: 各社チューブ10本に100µlのプラスミドDNA溶液 (濃度：104コピー/µl) を分注し、37°Cで振とう攪拌した。


3時間培養後、リアルタイムPCRを用いてDNA含有量を測定した。一例として、この図では10個のテスト系列中の1つを示しています。

SARSTEDTのMultiply® PCRプレート – 最大限の信 頼性





スカート付PCRプレート - 最大効率とばらつきの削減

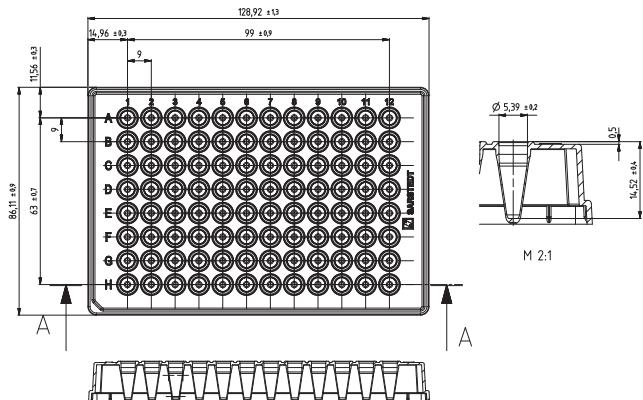

製品情報

- › プロファイル : Low Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.1 ml
- › カットエッジ : H1

特徴および利点

- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- ANSIに準拠した寸法のため自動システムで使用することができます。
- 各ウェルの隆起したリムが相互汚染を防止し、プレートシールやホイルで確実にシールすることができるため、蒸発によるロスを防ぎます。
- 黒い英数字表記により、手作業で充填する場合のサンプルの識別やトレーサビリティといった利便性が向上します。

- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance TestedとBiosphere® plusの優れた清潔度が保証されます。
- 一つ一つのウェルの100パーセントの気密性をテストし、貴重なサンプルの最高安全性を確保します。
- 簡単かつ確実に積み重ねることができるため、限られた保管スペースを効率的に使用できます。

96ウェルPCRプレートスカート付

名称	色	清潔度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
96ウェルPCRプレート スカート付	<input checked="" type="checkbox"/>		10 / 100	72.1980
96ウェルPCRプレート スカート付	<input checked="" type="checkbox"/>		1 / 20	72.1980.201
96ウェルPCRプレート スカート付	<input type="checkbox"/>		10 / 100	72.1980.010
96ウェルPCRプレート スカート付, DNA Low Binding	<input checked="" type="checkbox"/>		10 / 100	72.1980.700

その他のカラーバリエーションおよびバーコードタイプはお問い合わせください。
適合キャップとプレートシールはP.24~27をご覧ください。

凡例

色

白

透明

パッケージ

UV 製品の最小の二次包装

IK 内箱、IK内にはUVが入ります


UK 外箱、通常は最低注文量




Protein Low Binding PCRプレート スカート付

タンパク質やペプチドのマススペクトル分析で、通常のガラスバイアルや通常のPP容器を用いた場合、タンパク質やペプチドをロスすることはよく知られています。タンパク質濃度が一定の値を下回った場合、従来のチューブを用いたタンパク質分析の信頼性はかなり下がります。そのため当社では、サンプル調整、サンプル充填、および氷点下

(-20°C～-80°C) でのごく微量のサンプルの保管用として、スカート付Protein Low Binding 96ウェルプレートを提供しています。さらにこのプレートは、免疫沈降、タンパク質の精製または単離、タンパク質／ペプチド／抗体サンプルの調整あるいは保存に使用するのに最適です。

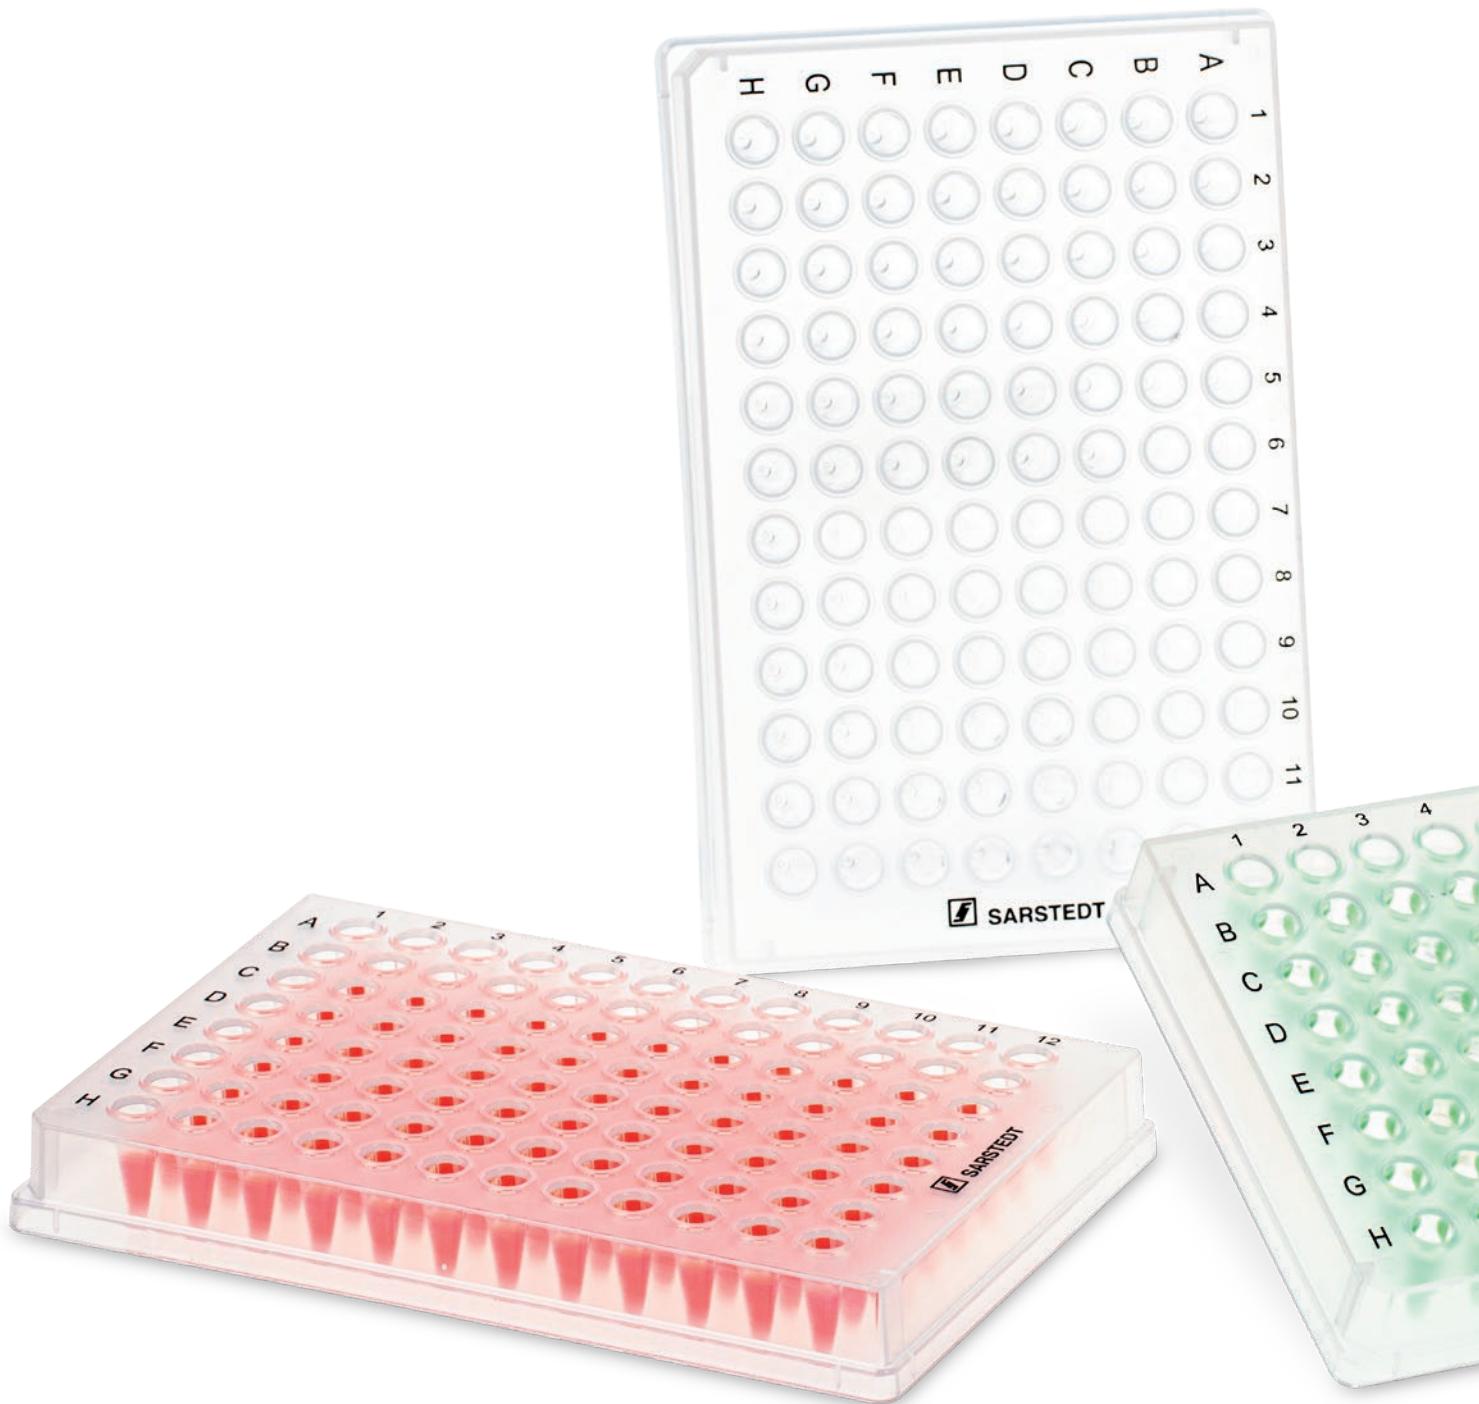


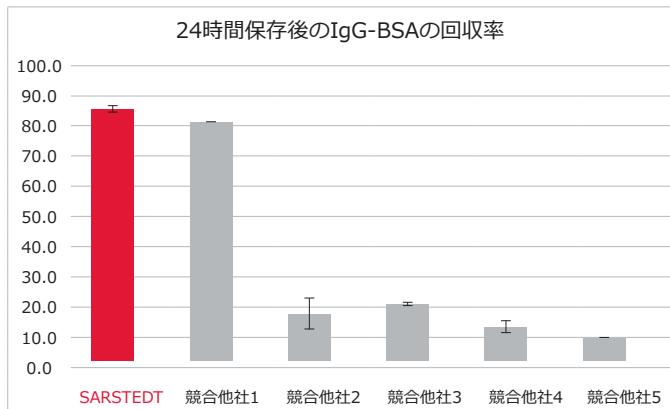

BSA-FITC共役溶液 (PBS中1.0 µg/ml ; ThermoFisher Scientific、商品番号A23015) をそれぞれ8 x 125 µl、SARSTEDTならびに競合5社のProtein Low Binding製品に24時間保存した。培養後、それぞれ100 µlを、あらかじめ2時間以上1 x Roti-Block (Carl Roth、商品番号A151.4) でブロックした黒色ELISAプレート (SARSTEDT、商品番号82.1581.220) に移し、プレートリーダーInfinite 200 pro(Tecan)で測定、テストは3日間連続で行った。SARSTEDT Protein Low Binding製品での保存は、テストしたほとんどの競合製品とは対照的に、目立った損失は見られなかった。ただし競合他社製品で同様の高い回収率を示したのもただ1社あった。

96ウェルPCRプレートスカート付

名称	色	清浄度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
96ウェルPCRプレートスカート付、Protein Low Binding	□		10 / 100	72.1980.600
PCR8連キャップ	□		120 / 480	65.989.002

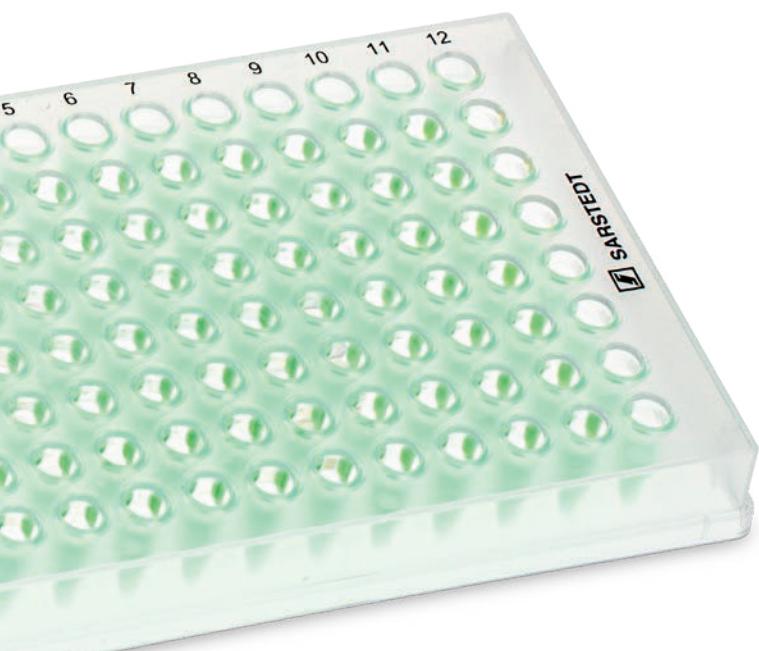


メモ

サンプルの保存には適合キャップ 65.989.002をお勧めします。



ハーフスカート付PCRプレート - High Profile

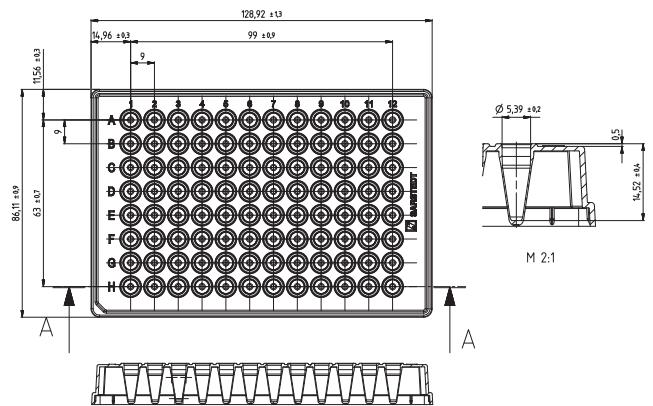

製品情報

- › プロファイル : High Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.2 ml
- › カットエッジ : A12

特徴および利点

- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- 各ウェルの隆起したリムが相互汚染を防止し、プレートシールやホイルで確実にシールすることができるため、蒸発によるロスを防ぎます。
- 黒い英数字表記により、手作業で充填する場合のサンプルの識別やトレーサビリティといった利便性が向上します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance TestedとBiosphere® plusの優れた清浄度が保証されます。
- 一つ一つのウェルの100パーセントの気密性をテストし、貴重なサンプルの最高安全性を確保します。
- 簡単かつ確実に積み重ねることができるため、限られた保管スペースを効率的に使用できます。

96ウェルPCRプレートハーフスカート付

名称	色	清潔度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
96ウェルPCRプレートハーフスカート付	☒		10 / 50 / 100	72.1979
96ウェルPCRプレートハーフスカート付	☒		1 / 10 / 20	72.1979.201
96ウェルPCRプレートハーフスカート付	☐		10 / 50 / 100	72.1979.010
96ウェルPCRプレート ハーフスカート&バーコード付き	☒		10 / 50 / 100	72.1979.003
96ウェルPCRプレートハーフスカート付、 DNA Low Binding	☒		10 / 50 / 100	72.1979.700
96ウェルPCRプレート ハーフスカート&フラットデッキ付き	☒		5 / 25 / 100	72.1979.102
96ウェルPCRプレート ハーフスカート&フラットデッキ付き	☐		5 / 50 / 100	72.1979.132

その他のカラーバリエーションおよびバーコードタイプはお問い合わせください。
適合キャップとプレートシールはP.24~27をご覧ください。






ハーフスカート付PCRプレート - Low Profile


特徴および利点

- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- ANSIに準拠した寸法のため自動システムで使用することができます。
- 各ウェルの隆起したリムが相互汚染を防止し、プレートシールやホイルで確実にシールすることができるため、蒸発によるロスを防ぎます。
- 黒い英数字表記により、手作業で充填する場合のサンプルの識別やトレーサビリティといった利便性が向上します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance Testedの優れた清浄度が保証されます。
- 一つ一つのウェルの100パーセントの気密性をテストし、貴重なサンプルの最高安全性を確保します。
- 簡単かつ確実に積み重ねることができるため、限られた保管スペースを効率的に使用できます。

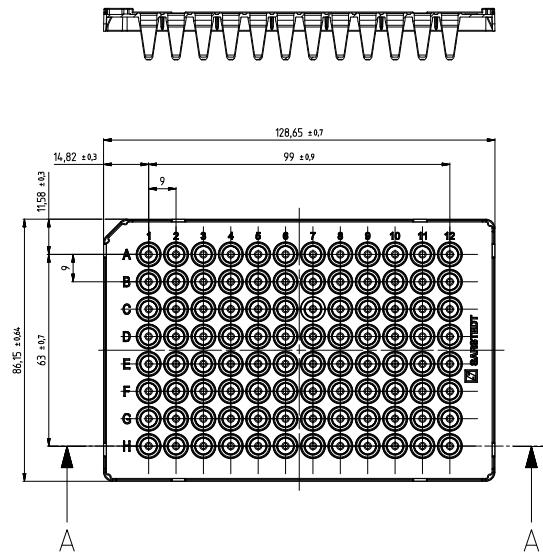

製品情報

- › プロファイル : Low Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.1 ml
- › カットエッジ : A1

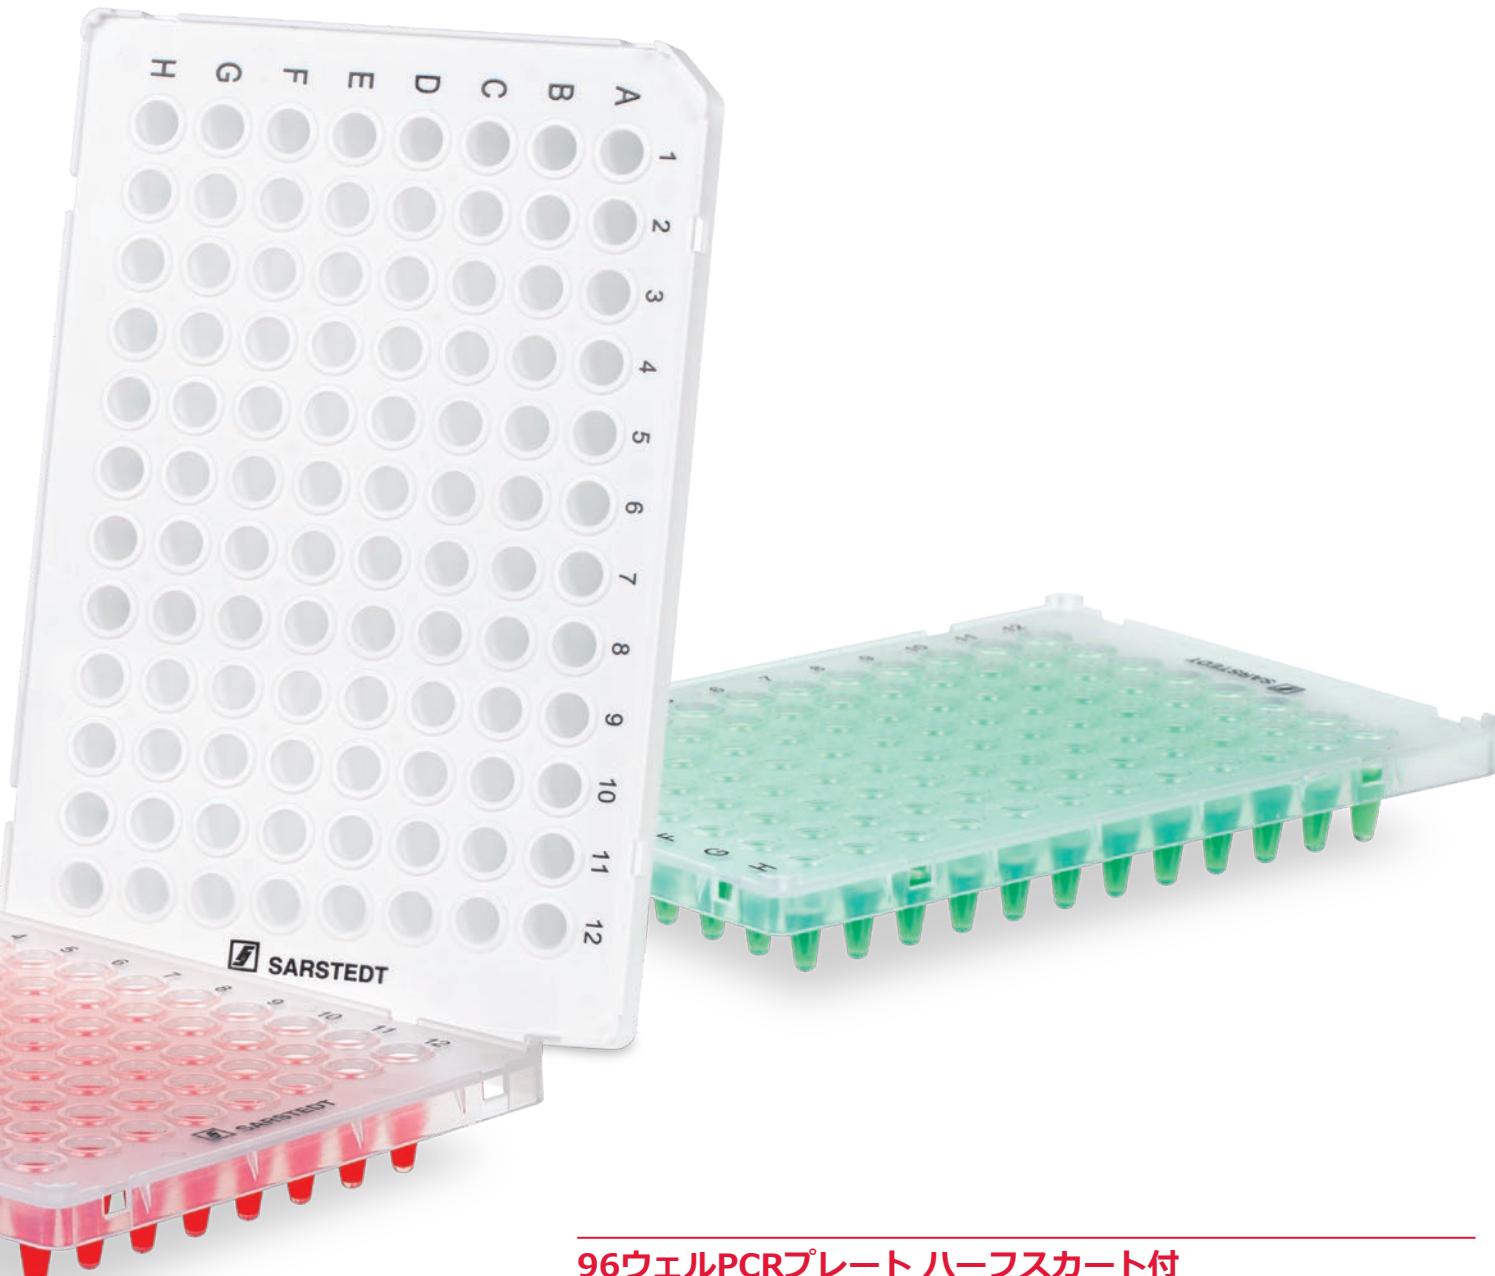

96ウェルPCRプレート ハーフスカート付

名称	色	清潔度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
96ウェルPCRプレート ハーフスカート付	<input checked="" type="checkbox"/>		10 / 50 / 100	72.1981
96ウェルPCRプレート ハーフスカート付	<input type="checkbox"/>		10 / 50 / 100	72.1981.010
96ウェルPCRプレート ハーフスカート付 Lightcycler 480 用	<input type="checkbox"/>		10 / 50 / 100	72.1982.252


他のカラーバリエーションおよびバーコードタイプはお問い合わせください。
適合キャップとプレートシールはP.24~27をご覧ください。



PCRプレート（スカートなし）－ High Profile



特徴および利点

- サンプル量が微量である場合、または24ウェルあるいは48ウェルフォーマットが必要な場合、簡単にカットできます。
- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- ANSIに準拠した寸法のため、自動システムで使用することができます。
- 各ウェルの隆起したリムが相互汚染を防止し、プレートシールやホイルで確実にシールすることができるため、蒸発によるロスを防ぎます。
- 黒い英数字表記により、手作業で充填する場合のサンプルの識別やトレーサビリティといった利便性が向上します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance Testedの優れた清浄度が保証されます。
- 一つ一つのウェルの100パーセントの気密性をテストし、貴重なサンプルの最高安全性を確保します。
- 簡単かつ確実に積み重ねることができますため、限られた保管スペースを効率的に使用できます。

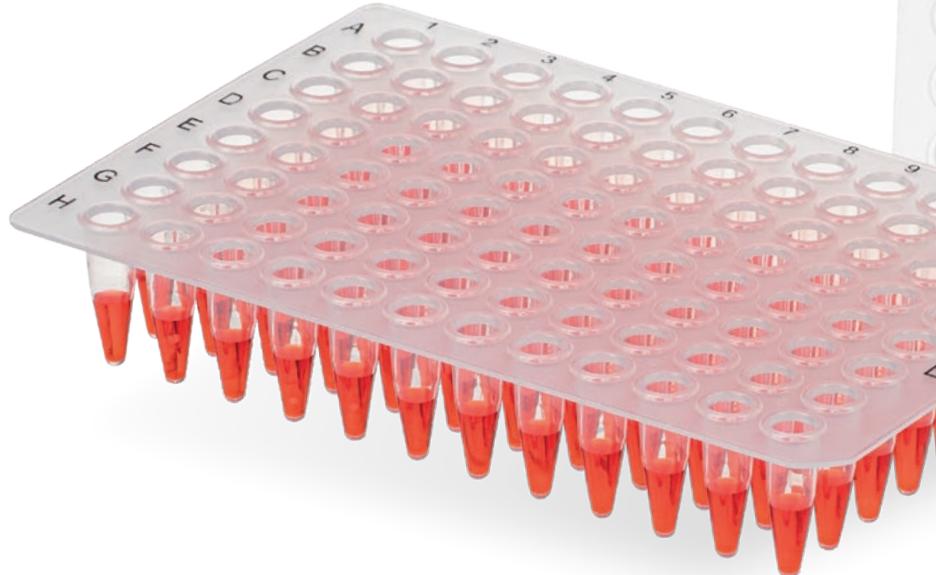

製品情報

- › プロファイル：High Profile
- › 最大ウェル容量：0.2 ml
- › カットエッジ：H12

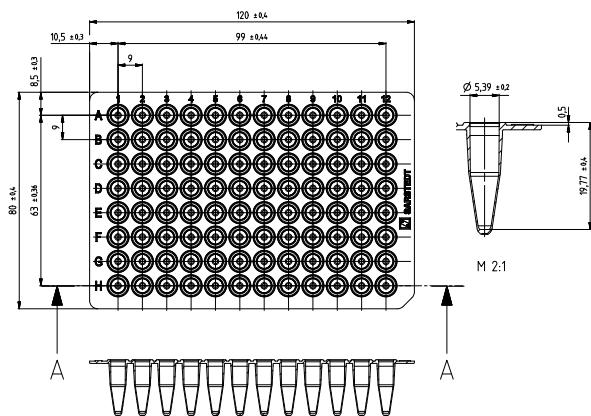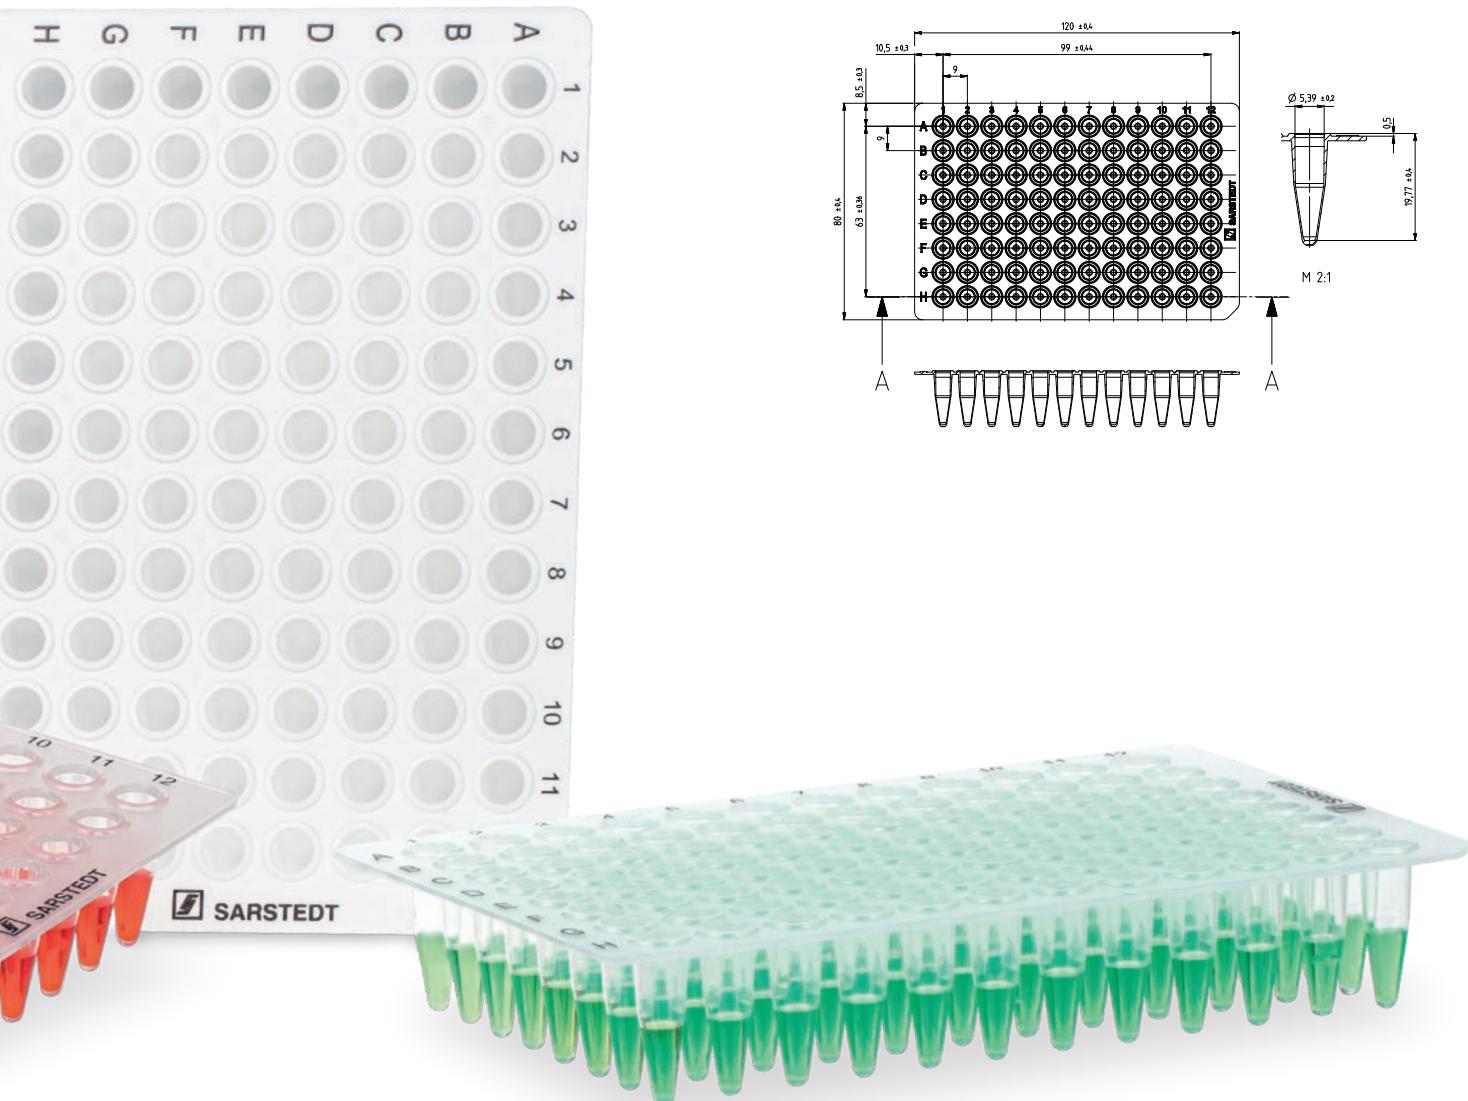


96ウェルPCRプレートスカートなし


名称	色	清潔度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
96ウェルPCRプレートスカートなし	<input checked="" type="checkbox"/>		10 / 50 / 100	72.1978
96ウェルPCRプレートスカートなし	<input type="checkbox"/>		10 / 50 / 100	72.1978.010

カラーバリエーションはお問い合わせください。
適合キャップとプレートシールはP.24~27をご覧ください。



PCRプレート（スカートなし） - Low Profile

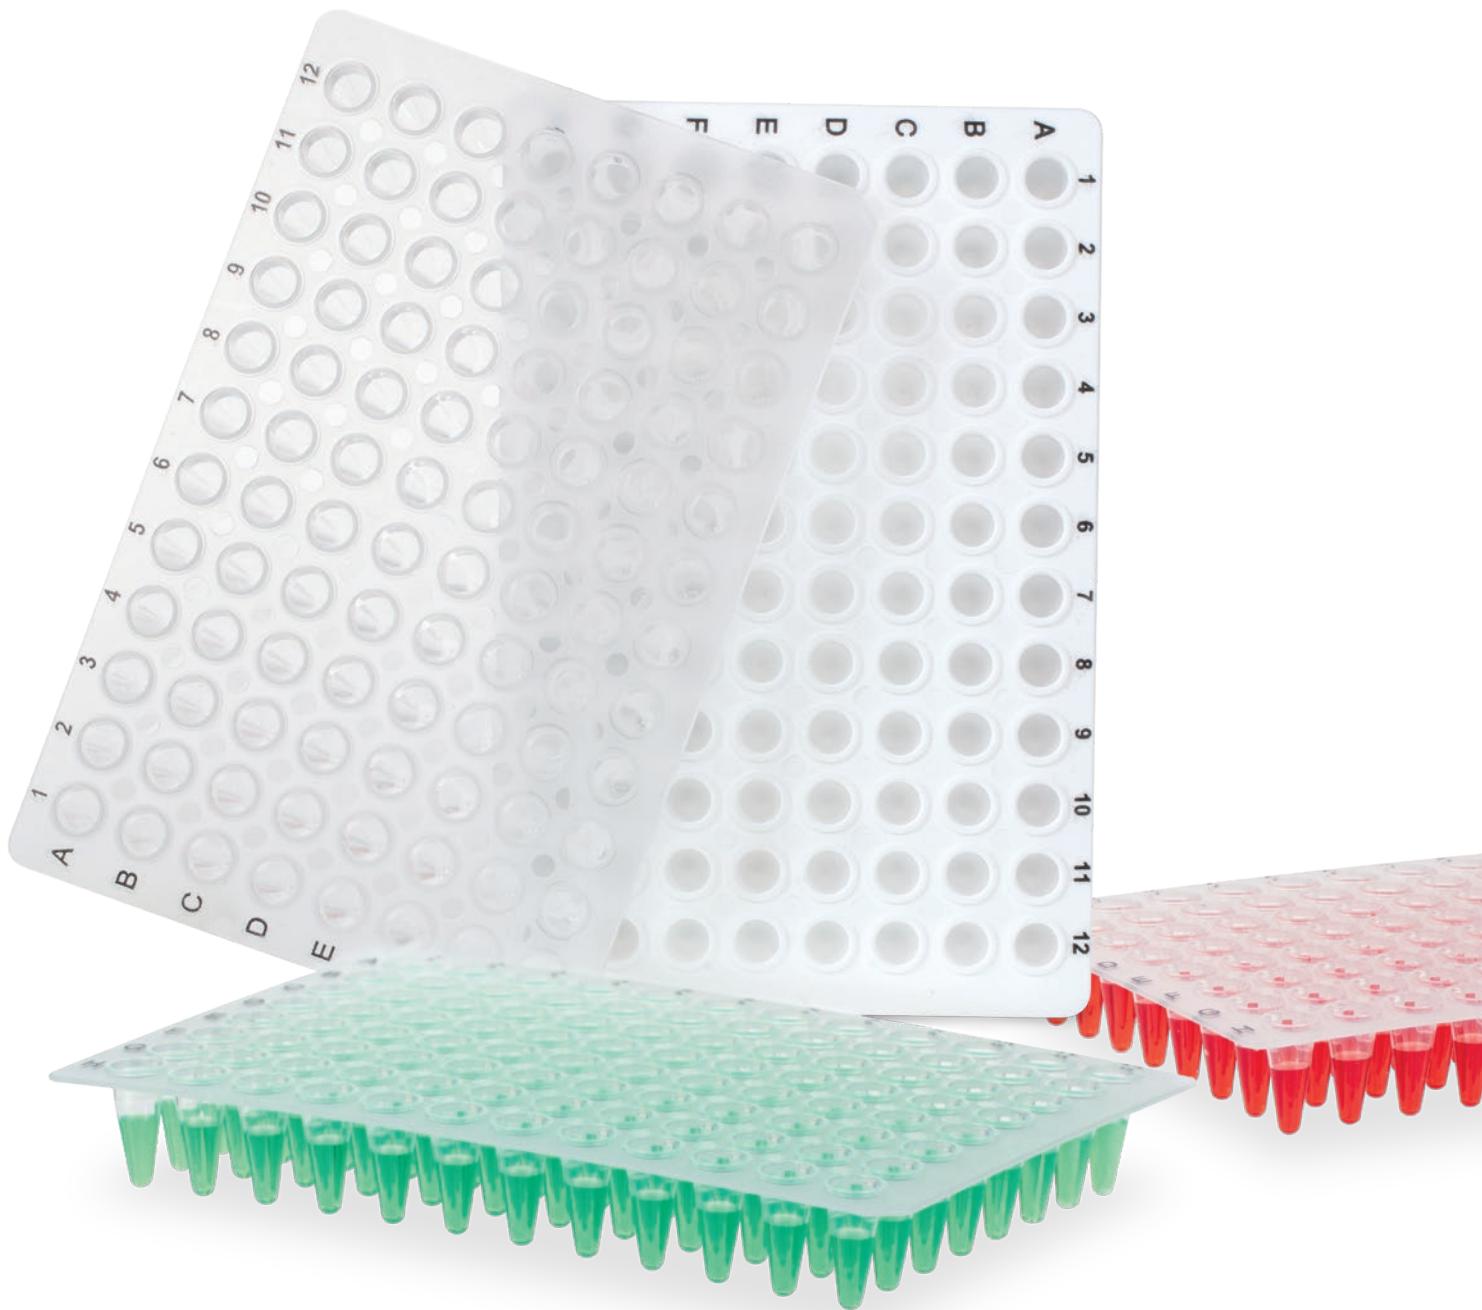

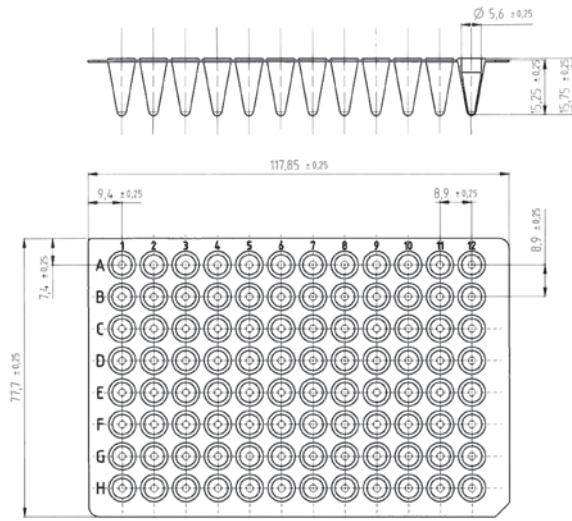

製品情報

- › プロファイル : Low Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.1 ml
- › カットエッジ : H12

特徴および利点

- サンプル量が微量である場合、または24ウェルあるいは48ウェルフォーマットが必要な場合、簡単にカットできます。
- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- ANSIに準拠した寸法のため自動システムで使用することができます。
- 各ウェルの隆起したリムが相互汚染を防止し、プレートシールやホイルで確実にシールすることができるため、蒸発によるロスを防ぎます。

- 黒い英数字表記により、手作業で充填する場合のサンプルの識別やトレーサビリティといった利便性が向上します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance Testedの優れた清浄度が保証されます。
- 簡単かつ確実に積み重ねることができるため、限られた保管スペースを効率的に使用できます。




96ウェルPCRプレートスカートなし

名称	色	清浄度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
96ウェルPCRプレートスカートなし	<input checked="" type="checkbox"/>		10 / 20 / 100	72.1977.202
96ウェルPCRプレートスカートなし	<input type="checkbox"/>		10 / 20 / 100	72.1977.232



384 ウエルPCRプレート



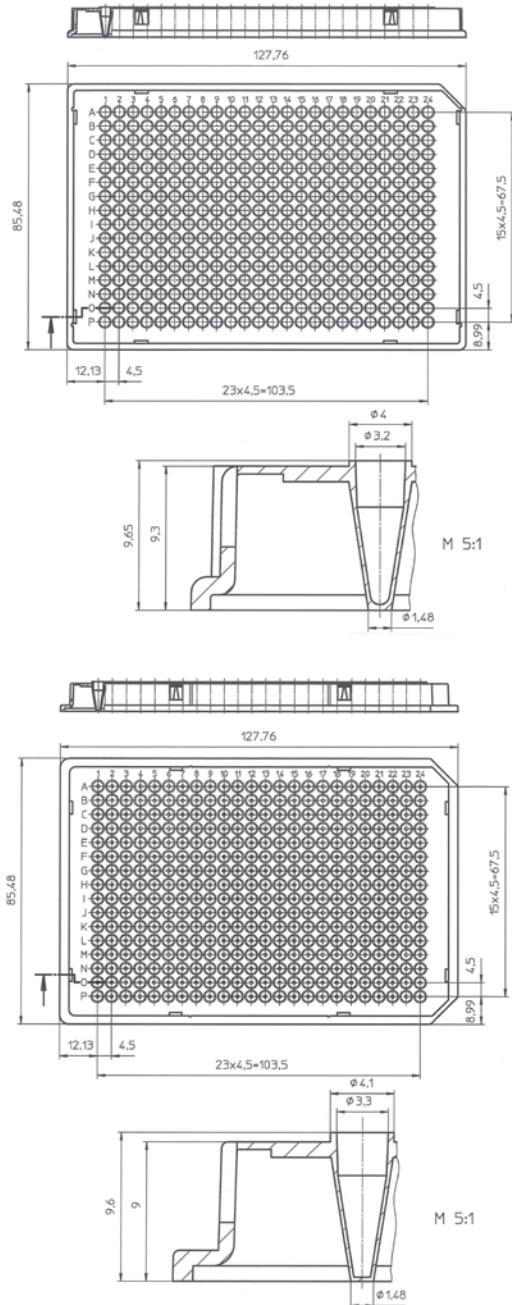

製品情報

- › プロファイル : Low Profile
- › 最大ウェル容量 : 40 µl
- › カットエッジ : A24またはA24 & P24

特徴および利点

- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- ANSIに準拠した寸法のため自動システムで使用することができます。
- 各ウェルの隆起したリムが相互汚染を防止し、プレートシールやホイルで確実にシールすることができるため、蒸発による口スを防ぎます。
- 黒い英数字表記により、手作業で充填する場合のサンプルの識別やトレーサビリティといった利便性が向上します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance Testedの優れた清浄度が保証されます。

384ウェルPCRプレートスカート付

名称	色	清浄度	パッケージ (UV/IK/UK)	Art. No.
384ウェルPCRプレートスカート付	☒	PCR Performance Tested	25 / 50	72.1984.202
384ウェルPCRプレートスカート付	☐	PCR Performance Tested	25 / 50 / 100	72.1985.202

Multiply® PCRプレート - 互換表

ウェル数	96	96	96	96	96	384
ハーフ／フル スカート	なし	なし	ハーフ	フル	ハーフ	フル
プロファイル	High	High	High	Low	Low	-
	72.985	72.1978 72.1978.010	72.1979 72.1979.010 72.1979.003 72.1979.201 72.1979.700 72.1979.102 72.1979.132	72.1980 72.1980.010 72.1980.201 72.1980.600 72.1980.700	72.1981 72.1981.010	72.1984.202
Art.No. PCRプレート						
Amersham Biosciences® / GE Healthcare®						
MegaBACE 500/1000 DNA分析システム				●		
MegaBACE 4000 DNA分析システム					●	
Analytik Jena® / Biometra®						
FlexCycler ² 96 Well		●				
qTOWER 2.0/2.2 SP	●	●		●		
SpeedCycler ² 96 Well SP & SPR	●	●		●		
TAdvanced	●	●				
TOne		●	●	●		
TOptical	●	●		●		
TRobot 96 Well	●	●		●		
TRobot 384ウェル					●	
Tprofessional シリーズ 96 Well (TRIO以外)		●		●		
Tprofessional シリーズ 384 Well (TRIO以外)					●	
Applied Biosystems® / Life Technologies®						
GeneAmp [®] 2700, 2720		●	●			
GeneAmp [®] 7500, 5700		●	●			
GeneAmp [®] 9600	●	●	●			
GeneAmp [®] 9700	●	●	●			
GeneAmp [®] 9800 FAST Block					●	
PE 2700		●	●			
PE 9600	●	●	●			
PE 9700	●	●	●			
Prism [®] 2720		●	●			
Prism [®] 7000 / 7700		●	●			
Prism [®] 7300 / 7500			●			
Prism [®] 7500 Fast					●	
Prism [®] 7900HT			●			●
Prism [®] 7900 Fast					●	
Prism [®] 7900HT Fast					●	●
QuantStudio™ (3, 5, 6, 7 & 12)			●		●	
StepOne Plus™					●	
Veriti [®] 96 Well / 384 Well			●			●
Veriti [®] Fast 96 Well			●		●	
ViiA7™			●			
310 Genetic Analyser		●	●			*
3100 / 3130 Genetic Analyser		●	●		●	*
3500 / 3500XL Genetic Analyser			●		●	*
3700 / 3730 / 3730XL Genetic Analyser		●	●		●	*
PeqLab®						
peqSTAR 96		●	●	●		
peqSTAR 384						●
Thermo Fisher Scientific®						
MultiBlock System		●		●		●
PCR Sprint		●		●		

互換表は指定の機器に対する推奨製品を掲載しています。ただし、その互換性は定期的にテストしている訳ではありません。したがって、その動作を保証するものではありませんのでご注意ください。

凡例 :

- = 推奨
- = 検査無し

*ABI社製の付属アダプター付き

Multiply® PCRプレート - 互換表

ウェル数	96プラグイン	96	96	96	96	384	96	384
ハーフ／フル スカート	なし	なし	ハーフ	フル	ハーフ	フル	フル	フル
プロファイル	High	High	High	Low	Low	-	"Lightcycler"	"Lightcycler"
Art.No. PCRプレート	72.985	72.1978 72.1978.010	72.1979 72.1979.010 72.1979.003 72.1979.201 72.1979.700 72.1979.102 72.1979.132	72.1979 72.1979.010 72.1979.003 72.1979.201 72.1979.700 72.1979.102 72.1979.132	72.1980 72.1980.010 72.1980.201 72.1980.600 72.1980.700	72.1981 72.1981.010	72.1984.202 72.1982.252 72.1985.202	

BioRad® / MJ Research®

CFX96 Touch™ Real-Time PCR



CFX384 Touch™ Real-Time PCR



CFX Automation System II

T100™ Thermal Cycler



S1000™ Thermal Cycler



C1000Touch™ Thermal Cycler



iCycler iQ™ Thermal Cycler



iQ4™ Thermal Cycler



iQ5™ Thermal Cycler



MyCycler™ Thermal Cycler



Chromo4™



Opticon™、Opticon2™



BaseStation™



Corbett Research® / Qiagen®

Palm Cycler 96 Well



Palm Cycler 384 Well



Eppendorf®

Mastercycler® nexus



Mastercycler® ep realplex



Mastercycler® gradient



Mastercycler® ep gradient



Mastercycler® pro



Ericom®

Deltacycler



SingleBlock



TwinBlock



MWG®

Primus 96 Well



Primus 384 Well



The Q-Lifecycler



Roche®

Lightcycler® 96 System



Lightcycler® 480 System



Stratagene® / Agilent®

AriaMx Real-Time PCR System



Mx3000PT™



Mx3005PT™



Mx4000™



Gradient Cycler



Robocycler 384 Well



Techne®

CycloGene



Flexigene



Genius / Genius Quad



OMN-E



PCR Express



Primus 96



Px2 / PxE



Quantica



TC412 / TC512




Touchgene/Touchgene Gradient



PCRチェーンキヤップ



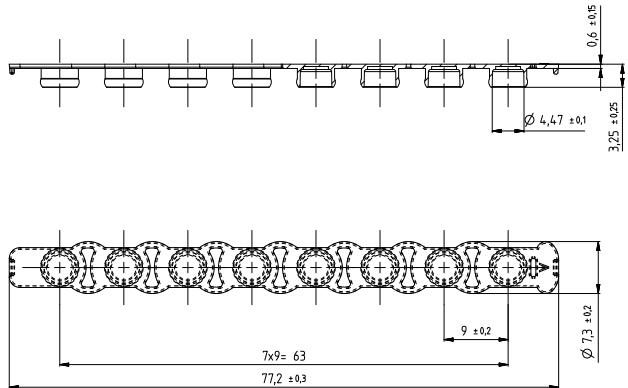

メモ

PCRプレートでのサンプルの保存には、簡単に密閉できる8連キャップでのシーリングをお勧めします。

特徴および利点

- PCRプレート／チューンチューブのシーリングに最適。
- リアルタイムPCRおよび蛍光ベースアプリケーション向けに最適化された透明度の高いチーンキャップ。
- しっかりと嵌合するよう精密にデザインしたチーンキャップとPCRプレート／チューブはしっかりと密閉できます。
- ストリップ先端の形状を工夫し、方向を間違いにくくなっています。
- PCRチューブ、PCRプレートのどちらとも適合します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance TestedとBiosphere® plusの優れた清浄度が保証されます。

PCR8連キャップ

名称	色	清潔度	適合プレート	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
PCR8連キャップ	□		72.1978 72.1978.010 72.1979 72.1979.010 72.1979.003 72.1979.201 72.1979.700 72.1980 72.1980.010 72.1980.201 72.1980.600 72.1980.700	12 / 240	65.989
PCR8連キャップ	□		72.1981 72.1981.010 72.985.002 72.985.092 72.985.992	120 / 480	65.989.002
PCR8連キャップ	□		72.1979.102 72.1979.132 72.1982.252	12 / 1200	65.1998.400

シーリングテープ/ホイル

ポリプロピレン、ポリスチレンやポリカーボネート製マイクロテストプレートの密閉においては、蒸発防止、アプリケーション中の検体保護、検体保管および発送のために、用途に応じたシーリングテープが必要となります。

ガルスタッフのシーリングテープは、PCR、作用物質の保管やハイスクレーブツクリーニングにおける高い要求に応えるべく開発されています。シーリングテープはすべてクリーンルーム条件下で製造され、DNase/RNaseやDNAによる汚染を防止します。



定量リアルタイムPCR(qPCR)用高透明シーリングテープ // REF 95.1999

50μmの薄いシーリングテープで、筋のつかない透明な粘着剤でコーティングされており、室温では最低限の粘着力しかありません。このためシールがグローブに貼りつくことなく、取扱いが容易になります。強力な粘着力はシールを押し付けることにより初めて発揮され、蒸発口を最小限に抑えます。



- リアルタイムPCR(qPCR)およびその他蛍光ベースの用途にオーダーメイドされた高透明シーリングテープ
- 革新的な粘着剤による確実なシーリング
- フィルム装着時に手袋に貼り付いて困ることがありません。
- カプセル状の粘着剤による最適な検体保護

定量リアルタイムPCR(qPCR)用透明シーリングテープ // REF 95.1993

50μm厚で、薄い層の粘着剤でコーティングされた透明度の高いポリエステルシールです。



PCR(qPCR)用透明シーリングテープ // REF 95.1994

PCR (qPCR) 用透明フィルム

- -70°Cまでの検体材料保管に最適
- きわめて堅牢で高耐久性



検体保管用強力透明シーリングテープ[®] // REF 95.1992


- -80°Cまでの検体保管に最適
- DMSOなどの溶剤に対して高い耐久性DMSO



PCRおよび検体保管用シーリングアルミホイル // REF 95.1995

熱に強く堅牢で突刺し可能な、薄さ38 µmのアルミホイルは、高い蒸発防止効果と高い溶剤耐久性が特徴です。ミシン目付のアプリケーションストリップは簡単に取外すことができます。

- アルミホイルはピペットチップで簡単に穴を開けることができます。
- -70°Cまでの検体材料/作用物質保管に最適

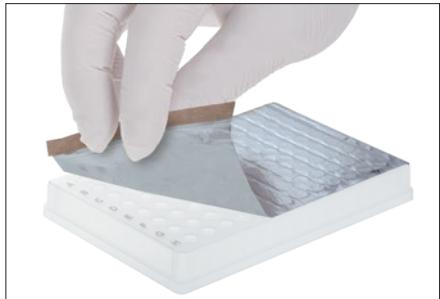

プロパティ

製品概要	アプリケーション	特性	光透過	貫通性	推奨使用温度	包装単位(UV/UK)	Art. No.
高透明qPCRシール	qPCR、蛍光分析	高透明で熱感度の高い粘着剤、低い蒸発率	+	なし	-80°C~100°C	100 / 1	95.1999
透明PCRシール	PCR、qPCR	薄い材質、高い視覚的透明性	+	なし	-40°C~120°C	100 / 1	95.1993
透明PCRシール	PCR,qPCR,検体保管	強い粘着力、高い薬品耐性	+	なし	-70°C~105°C	100 / 1	95.1994
粘着性アルミホイル	検体保管、PCR	突刺し可能、検体を光から保護、高い薬品耐性	-	あり	-70°C~105°C	100 / 1	95.1995
透明密閉シール	検体保管、PCR	極めて堅牢、低い蒸発率	+	なし	-80°C~120°C	100 / 1	95.1992

アプリケーション別推奨製シール



用途	特性	推奨製品	貫通性	剥離性
PCRおよびリアルタイムPCR(qPCR)	優れた透明性と検体の安全性、カプセル状の粘着剤	95.1999	なし	あり
	優れた透明性と標準的な粘着剤	95.1993	なし	あり
	標準的な透明性と検体の安全性	95.1994	なし	あり
蛍光および発行アッセイ	優れた透明性と検体の安全性、カプセル状の粘着剤	95.1999	なし	あり
	優れた透明性と標準的な粘着剤	95.1993	なし	あり
検体保管	光に敏感な検体の保管	95.1995	あり	ミディアム*
	-80°Cにおける標準的な検体保管	95.1992	なし	あり
蒸発防止 (PCR)	標準的な透明性と検体の安全性	95.1992	なし	あり

*ホイルはちぎれやすいため、一枚を一度に剥がすことは難しくなっています



実用的なプリセット式 - ポリカーボネート製フレーム付き2コンポーネントPCRプレートの代替品



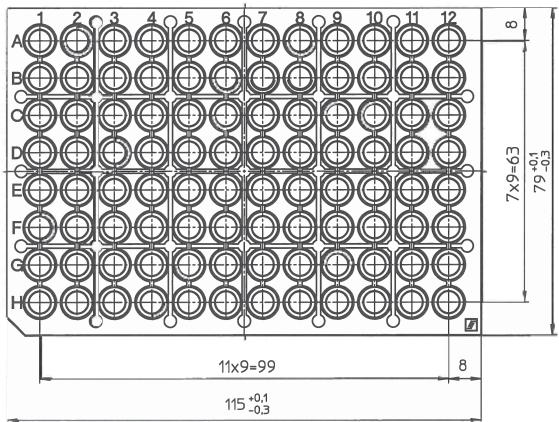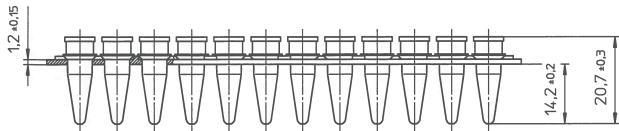

製品情報

- › プロファイル : High Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.2 ml

最高清浄度認証のPCRストリップ12本がプリインサートされたPCRワーキングトレイ

特徴および利点

- Biosphere® plus認証、個包装滅菌
- 高透明度チェーンキャップ65.989でシール可能
- ポリカーボネート製フレーム
- ラックシステムで使用可（37ページ参照）



96ウェルPCRストリップ（ワーキングトレイ入）

名称	色	清浄度	パッケージ(UV/UK)	Art. No.
96ウェルPCRストリップ (ワーキングトレイ入)	☒	Biosphere® plus	1 / 20	72.985
PCR8連キャップ、 Biosphere® plus	☒	Biosphere® plus	12 / 240	65.989



PCR8連チューブ（キャップ別）





製品情報

- › プロファイル : High Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.2 ml

特徴および利点

- しっかりと嵌合するよう精密にデザインしたチェーンキャップとPCRプレート/チューブはしっかりと密閉できます。
- ねじれ、折れ曲がり、破損がなく、強化された連結部分がPCRチューブのたるみを防ぎます。
- ストリップ先端の形状を工夫し、方向を間違いにくくなっています。
- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- PCRチューブ、PCRプレートのどちらとも適合します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance TestedとBiosphere® plusの優れた清浄度が保証されます。

8連PCRチューブ キャップ別

名称	色	清潔度	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
8連PCRチューブ キャップ別	図		120 / 480	72.985.002
8連PCRチューブ キャップ別	□		120 / 480	72.985.092
8連PCRチューブ キャップ別	■ ■ ■ ■		120 / 480	72.985.992
8連PCRチューブ キャップ別	図		120 / 480	65.989.002

その他のカラーバリエーションはお問い合わせください。

凡例

色
■ レッド

■ 緑

■ 青

■ 紫

□ 白

図 透明

パッケージ

UV 製品の最小の二次包装

IK 内箱、IK内にはUVが入ります

UK 外箱、通常は最低注文量



PCR8連チューブ（キャップ別）

特徴および利点

- しっかりと嵌合するよう精密にデザインしたチーンキャップとPCRプレート/チューブはしっかりと密閉できます。
- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance Testedの優れた清浄度が保証されます。
- 8連キャップ付セットパッケージ。

製品情報

- › プロファイル : Low Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.1 ml



8連PCRチューブ キャップ付

名称	色	清潔度	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
8連PCRチューブ キャップ付	□		125 / 1250	72.982.002
8連PCRチューブ キャップ付	□		125 / 1250	72.982.092



個別キャップ一体型PCRチェーン

特徴および利点

- 取り扱いやすさはそのままに安全性を向上。
キャップ内側に誤って触れないように、
コンタミネーション防止カバーが付いています。
- ねじれ、折れ曲がり、破損なし。
- 強化された連結部分がPCRチューブのたるみを防ぎます。
- キャップ天面には大きな書き込みスペースがあります。
- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施するため、PCR Performance TestedとBiosphere® plusの優れた清浄度が保証されます。

製品情報

- › プロファイル : High Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.2 ml



個別キャップ一体型PCRチェーン

名称	色	清浄度	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
キャップ一体型8連PCRチューブ	■	PCR Performance Tested	120 / 480	72.991.002
キャップ一体型8連PCRチューブ	■ ■ ■ ■	PCR Performance Tested	120 / 480	72.991.992
キャップ一体型4連PCRチューブ	■	PCR Performance Tested	120 / 480	72.990.002
キャップ一体型4連PCRチューブ	■	Biosphere® plus CERTIFIED	120 / 480	72.990
キャップ一体型4連PCRチューブ	■ ■ ■ ■	PCR Performance Tested	120 / 480	72.990.992

キャップ一体型8連PCRチューブ (0.1 ml)

名称	色	清浄度	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
キャップ一体型8連PCRチューブ	■	PCR Performance Tested	120 / 480	72.991.103





キャップ付シングルPCRチューブ

特徴および利点

- 取り扱いやすさはそのままに安全性を向上。
キャップ内側に誤って触れないように、
コンタミネーション防止カバーが付いています。
- Qubit™ Fluorometerとの使用に適した0.5mlチューブ
- キャップ天面には大きな書き込みスペースがあります。
- 非常に均一かつ薄いウェル壁により、一貫して均等で最速の
熱伝導が可能。信頼性と高い再現性の結果を保証します。
- クリーンルーム条件で製造し、別途生物学的試験を実施す
るため、PCR Performance TestedとBiosphere® plusの
優れた清浄度が保証されます。

製品情報

- › プロファイル : High Profile
- › 最大ウェル容量 : 0.2 ml & 0.5 ml



メモ

原則として、サイクラーの蓋からPCRチューブへの熱と圧力の均一な分布を確保するため、サイクルのブロックを常に対称的に満たす必要があります。

キャップ付シングルPCRチューブ

名称	色	清潔度	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
0.2ml シングルPCRチューブ	□		500 / 2000	72.737.002
0.2ml シングルPCRチューブ	□		250 / 2000	72.737
0.2ml シングルPCRチューブ	■ ■ ■ ■		500 / 3000	72.737.992
0.5ml シングルPCRチューブ	□		500 / 2000	72.735.002
0.5ml シングルPCRチューブ	□		100 / 1000	72.735.100
0.5ml シングルPCRチューブ	■ ■ ■ ■		500 / 3000	72.735.992

インテリジェントなラック&ピペットシステム

貴重なサンプルの確実な冷却を実現する IsoFreeze® PCR Rack

多くの場合サンプル調整には一貫した確実なサンプル冷却が必要となります。そのためSARSTEDTでは、温度に敏感な用途向けに、信頼性の高い温度制御機能を備えたピッティング／ワークステーション、IsoFreeze® PCR Rackを提供しています。

特徴および利点

- 最適温度範囲（7°Cまで）以上になると、紫からピンクにはっきりと色が変わります。
- 氷上でサンプルを保管する必要がなくなるため、汚染リスクが最小限に抑えられます。
- 通常の周囲温度の場合、サンプル温度を最大3時間（カバーを付けた場合）最適な範囲に維持します。
- 0.1ml & 0.2ml PCRプレート／ストリップ／チューブ向けの8 x 12フォーマット、または1.5ml & 2.0mlチューブ向けの6 x 4フォーマットがあります。

IsoFreeze®



名称	パッケージ (IK/UK)	Art. No.
IsoFreeze® PCR Rack 96ウェルフォーマット	2 / 1	95.984
IsoFreeze® MCT Rack 24ウェルフォーマット	1 / 1	95.983



SARSTEDTラックシステム - フレキシブルな保管/ピッティングステーション

特徴および利点

- ワークトレイとベースステーションからなるフレキシブルな2コンポーネントシステム
- ワークトレイを使用してサーマルサイクラーに移動できるため、PCRストリップとシングルチューブの処理時間を削減
- 各種カラーオプションのベースステーションで検査室の整理が簡単

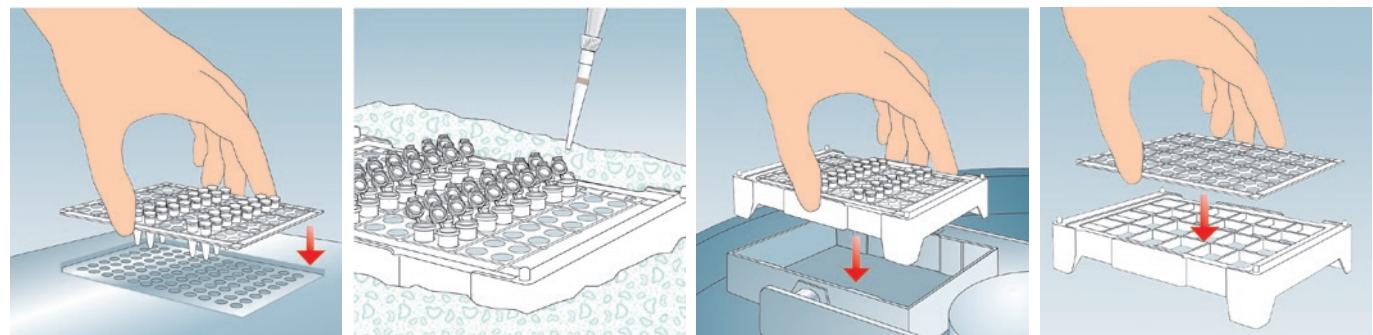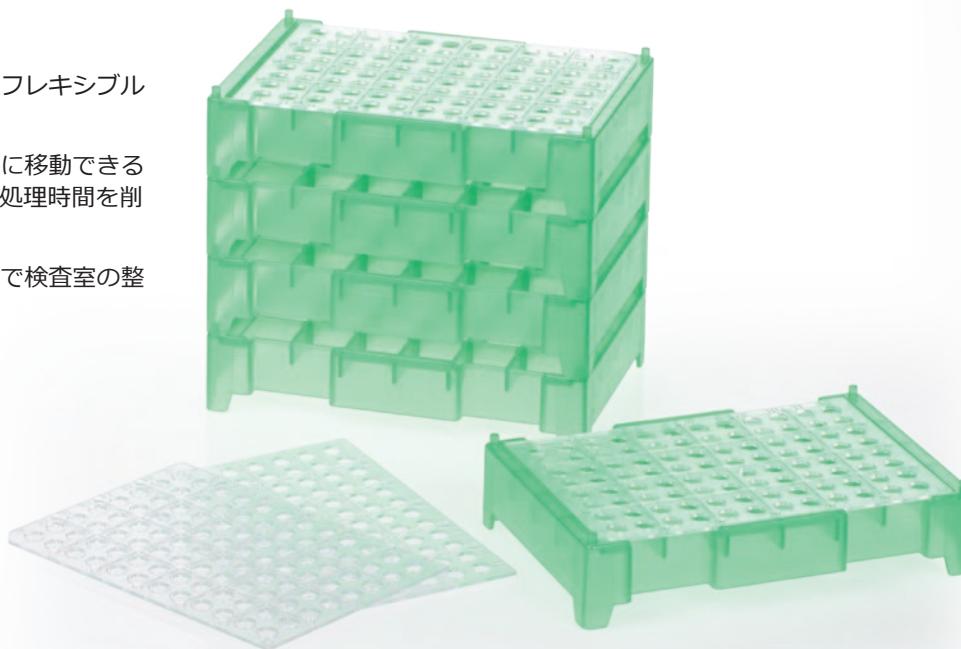

アクセサリー

名称	パッケージ (UV/UK)	Art. No.
96ウェルワートレイ	5 / 100	95.987.002
ベースステーション (透明)	5 / 75	95.988
ベースステーション (赤)	5 / 75	95.988.001
ベースステーション (青)	5 / 75	95.988.002
ベースステーション (緑)	5 / 75	95.988.003
ベースステーション (黄)	5 / 75	95.988.004

正常なPCR反応を実現するためのヒント／ガイドライン

一般的推奨事項

- DNAは必ず水ではなくTris-EDTAバッファ(pH 8)に保存し、分解を防いでください。
- フィルタ付きのピペットチップを使用し、(相互)汚染を防ぐために手袋を着用してください。
- 相互汚染のリスクが高まるため、換気されたクリーンベンチで反応混合物をピペッティングすることは避けてください。
- 反応混合物は、できるだけ他の分子生物学用途に使用することのない、清潔な場所でピペッティングしてください。
- 反応混合物をピペッティングする際は、DNAポリメラーゼを最後の成分として加えてください。
- 破壊される恐があるため、ヌクレオチド(dNTPs)を再解凍、再凍結しないでください。ヌクレオチド(およびプライマー)は分注して-70°Cで保存することをお勧めします。
- 増幅には1 kb DNAテンプレートにつき一分間の伸長を考慮してください。
- 消耗材はDNAフリー、DNase/RNaseフリーならびにPCR阻害剤フリー認定されたものを使用し、産物が望ましくない生体分子によって汚染される危険を避けるため、消耗材を使用前にオートクレーブ処理しないようにしてください。
- PCR産物はゲルから切り取ったらできるだけUV光にさらさないようにし、DNA配列エラーの発生を防止してください。

DNAテンプレートの使用に関するガイドライン

- 25~30サイクルでPCR産物を検出するには、およそ100テンプレートコピーが必要となります。テンプレートDNAのコピーが10未満である可能性が高い場合、少なくとも40サイクル以上を使用してください。
- 経験則：プラスミドDNAを使用する場合は1pg~1ngのテンプレート濃度を、ゲノムDNAを使用する場合は1ng~1μgの濃度を採用します。これよりも高いテンプレート濃度を使用すると反応の特異性が低下し、それによって非特異的なPCR産物の発生が増加します。
- DNAテンプレートの純度を測光的に検査し(260/280nmの比率は1.8以上である必要があります)、テンプレートがPCR阻害剤で汚染されていないことを確認して、汚染が認められた場合はDNA分離キットを使用するか、エタノール沈殿を実行します。
- 必要に応じてゲル電気泳動を使用し、DNAテンプレートが分解されているかを確認します。

プライマーの使用に関するガイドライン

- 経験則：プライマーあたり0.05~1 μMの最終プライマー濃度を使用します。これよりも高いプライマー濃度を使用すると、プライマーの非特異的結合により、非特異的なPCR産物の発生が増加します。最終反応ではプライマーあたり0.2 μMの濃度が最適となる場合がよくあります。
- プライマーの長さは20~30ヌクレオチドであることが望ましいです。
- プライマーのGC含有量は理想的には40 %~60 %とし、GC分子はプライマーの長さ全体に均等に分布している必要があります。GC含有量の高いPCR産物の増幅を最適化するため、反応混合物にDMSOを加えることができます。DMSOなどの添加剤を使用する場合、高濃度ではプライマー結合が弱くなる可能性があるため、アニーリング温度を調整する必要がある場合があります。この場合はできる限り低い濃度を使用し、テストアプローチで10%を超えないようにしてください。
- 使用するプライマーペアのアニーリング温度(Tm)は5°C以上差が開かないようにし、50°C~72°Cの温度範囲にあるようにします。
- 低いTmのプライマーの算出されたTmよりも0~5°C下回るアニーリング温度を使用します。


PCRトラブルシューティング・チェックリスト

問題	考えられる原因	対策
	反応混合物にPCR阻害剤が含まれている	DNAフリー、DNase/RNaseフリーならびにPCR阻害剤フリー認定された消耗材を使用してください。DNAテンプレートの純度を測光的に検査し、テンプレートがPCR阻害剤（フェノール、プロテイナーゼK、K+、Na+など）で汚染されていないか確認してください。260/280 nm の比率が1.8未満の場合は、DNA精製キットを使用するか、エタノール沈殿を実行し、PCR阻害剤を排除してください。 またはテンプレート（結果としてPCR阻害剤）を希釈し、DNAポリメラーゼ濃度を上げます。
増幅産物がない	PCRテンプレートが分解している	ゲル電気泳動を使用し、分解したPCRテンプレートがあるかを確認します。分解開始DNA（DNAスマア、バンドが小さすぎるなど）の兆候がみられた場合、新しいテンプレート分離を実行します。分離中のDNAせん断を最小限に抑えます。テンプレートDNAをTris-EDTAバッファ（pH 8）に保存し、分解を防いでください。
	最適ではない反応条件	アニーリング温度が高すぎる、変性時間が長すぎる、または使用されたサイクル数が少なすぎる可能性があります。1~2°Cずつ徐々にアニーリング温度を下げて最適化し、まずDNAを3分間変性させ（変性時間が長すぎるとDNAは分解する場合があります）、反応サイクル中に30秒間変性させるか、サイクル数を5サイクル増やします。
	反応混合物の成分を忘れた	PCRを繰り返します。
	汚染された試薬（水など）	PCR試薬（多くの場合使用する水）が直前のピペットイングプロセス中に誤って汚染された可能性があります。新しいPCR試薬を使用してください。
非特異的な増幅産物	最適ではない反応条件	アニーリング温度が低すぎる、サイクル数が高すぎる、または延長時間が長すぎる可能性があります。アニーリング温度が低すぎると、非特異的なプライマー結合が促進されます。温度勾配を使用して、最もクリーンなPCR産物を生成するのに最適なアニーリング温度を決定してください。サイクル数が高すぎて非特異的なPCR産物の増幅につながる場合があります。非特異的なPCR産物が発生した場合、試しにサイクル数を5サイクル減らしてください。長い伸長時間も非特異的な増幅を促します。PCR産物のサイズに応じてできるだけ正確な伸長時間を設定してください（1 kb DNAテンプレートあたりの増幅にはTaqポリメラーゼの場合およそ一分間の伸長時間を要します）。
	反応混合物中のMg ²⁺ が多すぎる	Mg ²⁺ 濃度が高すぎるとプライマーの非特異的結合が生じる可能性が高くなり、それに伴って不要なPCR産物が形成されます。この場合は使用するMg ²⁺ 量を減らしてください。
	PCRテンプレートが分解している	ゲル電気泳動を使用し、分解したPCRテンプレートがあるかを確認します。分解した出発DNA（DNAスマア、バンドが小さすぎるなど）の兆候がみられた場合、新しいテンプレート分離を実行します。分離中のDNAせん断を最小限に抑えます。テンプレートDNAをTris-EDTAバッファ（pH 8）に保存し、分解を防いでください。

ご不明な点がございましたらご遠慮なくお申し付けください！

当社のウェブサイト www.sarstedt.com
もご利用ください。

SARSTEDT の モレキュラー・
ダイアグノスティック・ワークフロー
各種製品の調和がもたらすメリット
を感じてください！

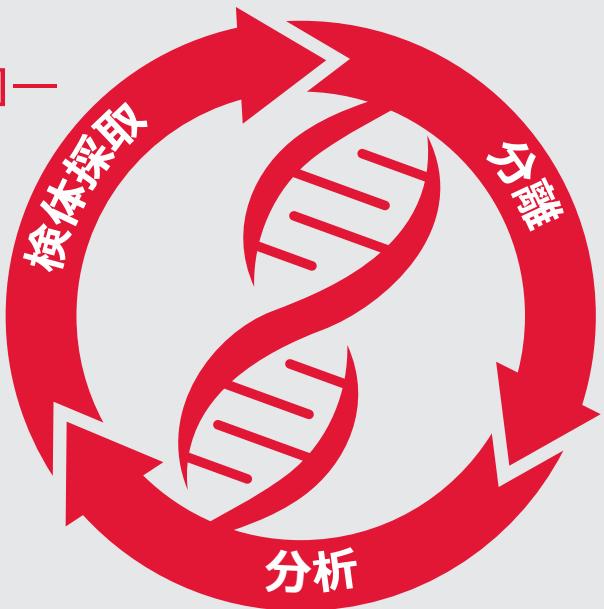

ザルスタッフ株式会社

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-11
内神田渋谷ビル 8階

Tel: +81 3 3526 3530

Fax: +81 3 3526 0870

info.jp@sarstedt.com
www.sarstedt.com

分子診断のオンラインワークフロー



[molecular-workflow.
sarstedt.com](http://molecular-workflow.sarstedt.com)